



■ 特 長

1. 高信頼性
2. 絶縁形出力付
3. 自動校正機能付
4. 現場設置型
5. 屋外防滴構造

FEATURES

1. High reliability
2. Isolation output
3. Automatic calibration
4. Field installation type
5. Splashproof construction


■ 仕 様

SPECIFICATIONS

MODEL 形 式	C P H - 3	C O R - 3
ITEM 品 名	Controller p H 指示調節計	Controller O R P 指示調節計
MEASURING OBJECT 測 定 項 目	p H	O R P
MEASURING PRINCIPLE 測 定 原 理	Glass electrode method ガラス電極方式	Metal electrode method 金属電極方式
MEASURING RANGE 測 定 範 囲	0 ~ 1 4 p H	± 1 9 9 9 m V
REPEATABILITY (not including sensor) 繰 返 性 (センサ含まず)	0 . 1 p H	1 0 m V
CALIBRATION 校 正 機 能	Auto calibration or 自動校正 (pH4,7又はpH7,9)	-----
DISPLAY 表 示	L E D (3 1/2 digits)	
CONTACT OUTPUT 接 点 出 力	Each A L M 1、A L M 2 各 1 a b	
CONTACT CAPACITY 接 点 容 量	(Resistance load) A C 2 5 0 V 5 A (抵抗負荷)	
DIF 警 報 動 作 幅	Step 0.1~1.9pH (0.1pHステップ)	Step 10~190mV (10mVステップ)
OUTPUT (standard) 出 力 (標 準)	Isolation 0~14pH/4~20mA 絶縁出力	Isolation ± 700mV/4~20mA 絶縁出力
POWER SOURCE 電 源	About AC100/AC200V ± 10% 50/60 Hz 約 10VA	
WORKING CONDITIONS 使 用 条 件	Temperature 温度 -10~50°C	Humidity less than 90% 湿度 90%以下
WEIGHT 重 量	About 約 2 . 5 k g	
STANDARD ACCESSORIES 標 準 添 付 品	Instruction manual 1 copy 取扱い説明書 1部	
CONSTRUCTION 構 造	Splashproof construction 防滴構造	
MOUNTING 取 付 方 法	Wall mounting or Pole mounting 壁掛取付 又は ポール取付	
OPTION オ プ シ ョ ン	Hood 屋外フード	

■ 構成図



CONSTITUTIONS

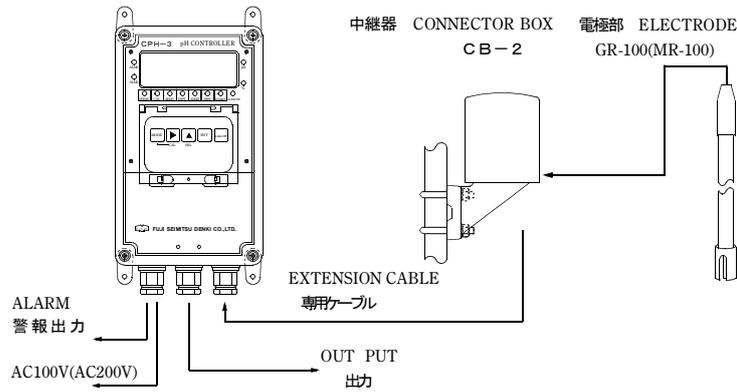


■ 外形寸法図

DIMENSIONS (mm)

■ 取付寸法図 MOUNTING DIMENSIONS

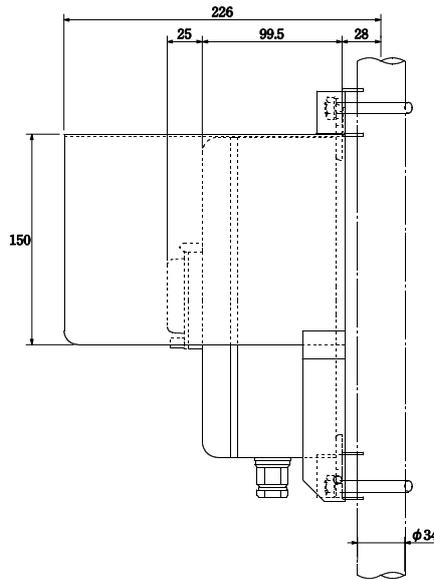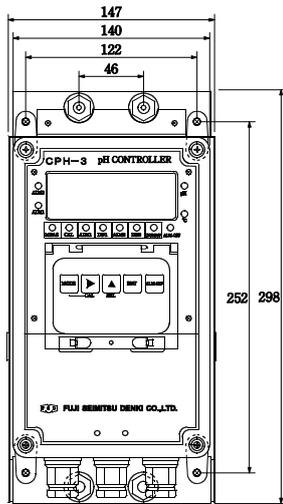


壁掛取付 Wall mounting

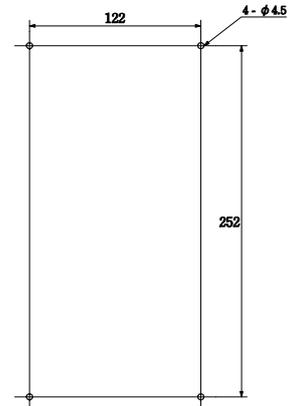

■ ご用命には

ORDER FORMULA

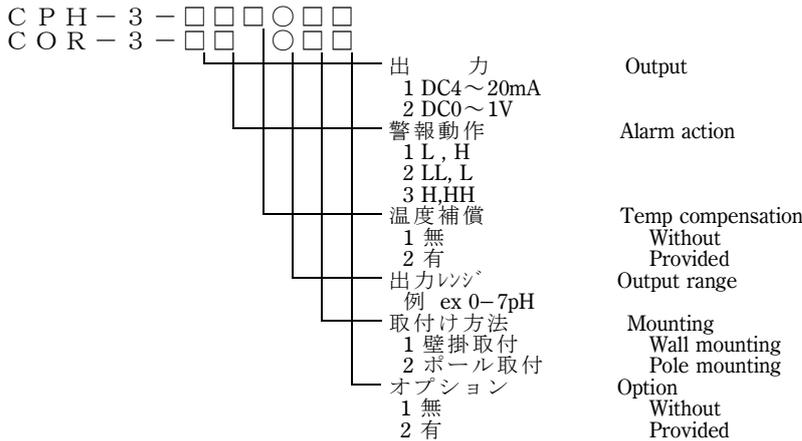

注 出力レンジは5pH (500mV) 幅以上で1pH (100mV) ステップでご指定ください。
 Caution Output range: In the range of more than 5pH (500mV) width and 1pH (100mV) step
 本カタログに記載された仕様は、品質改良のため予告無く変更することがあります。
 Specification described in this catalog will be subject to change without notice.

FSD 富士精密電機株式会社
 FUJI SEIMITSU DENKI Co.,LTD.

本社 〒153 東京都目黒区目黒2丁目15番14号
 Head Office 15-14, Meguro 2-chome, Meguro-Ku, Tokyo 153
 TEL: 03-3716-3441 (代表) FAX: 03-3716-3820

鷺津営業所 〒431-04 静岡県湖西市鷺津1122-2
 Wasizu Office 1122-2, Wasizu, Kosai-city, Sizuoka 431-04
 TEL: 053-576-0093 (代表) FAX: 053-576-4722

代理店 AGENT